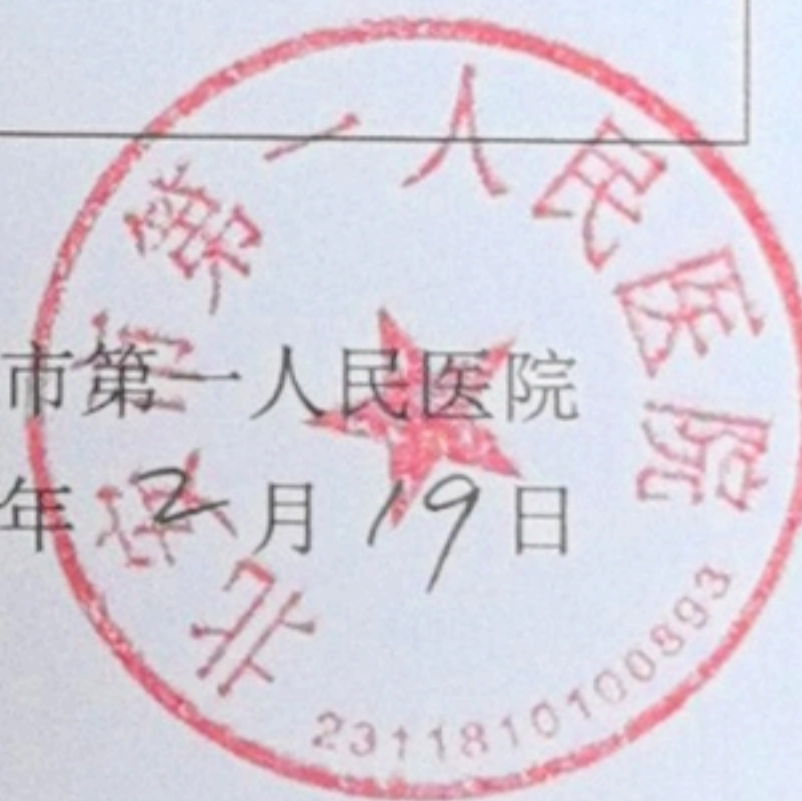


单一来源采购申请表

使用单位	北安市第一人民医院				
项目名称					
预算金额	序号	产品名称	规格	预算单价 (元)	预算总价 (元)
	1.	微量白蛋白 (mALB) 测定试剂盒 (散射比浊法)	50 测试/盒	53200.00	20000.00
		微量白蛋白 (mALB) 质控品	2*0.5ml/盒		
		微量白蛋白 (mALB) 校准品	2*0.5ml/盒		
		清洗液	1*5.0L		
		肌酐 (CREA) 校准品	2*0.5ml/盒		
		肌酐 (CREA) 质控品	2*0.5ml/盒		
	2.	肌酐 (CREA) 测定试剂盒 (肌氨酸氧化酶法)	50 测试/盒	64.00	
申请理由	<p>我院目前正在使用引进的【尿液蛋白分析仪 ACR-300】基于免疫散射比浊法和透射比色法相结合原理，与配套的【尿液蛋白分析仪 ACR-300 检测试剂】共同使用，在临床上对来源于人体的随机尿样本中的尿微量白蛋白，肌酐进行定量检测。符合国家医疗器械管理的相关要求。此仪器所用检测试剂均为专机专用配套试剂，仪器在进行定量检测时必须使用原厂专用检测试剂才能完成相关的检测工作得出准确的数值。其他厂家的检测试剂无法在此仪器上使用。【尿液蛋白分析仪 ACR-300】的生产厂家深圳普门科技股份有限公司为生产研发【尿液蛋白检测系列产品】的国际知名企业，拥有多项专利技术。黑龙江巴迪泰供应链管理有限公司是深圳普门科技股份有限公司系列产品黑龙江区域的唯一授权经销商。</p> <p>根据政府采购法第三十一条的适用条件，满足只能从唯一供应商处采购条件，现我院申请采用单一来源方式采购。</p>				

单位名称：北安市第一人民医院

2024年 2 月 19 日



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李太伟
	职称: 正高级工程师
	工作单位: 黑龙江省医院
项目信息	项目名称:
	供应商名称: 黑龙江巴迪泰供应链管理有限公司
专业人员论证意见	<p>经论证, 由于该院已购置普门尿液蛋白分析仪(ACR-300), 该设备配套试剂属于专用产品, 第三方品牌无法替代。因此, 根据政府采购法第三十一条规定, 建议采用单一来源的方式从现有供应商处采购。</p>
专业人员签字	<p>李太伟, 日期: 2024. 2. 19</p>

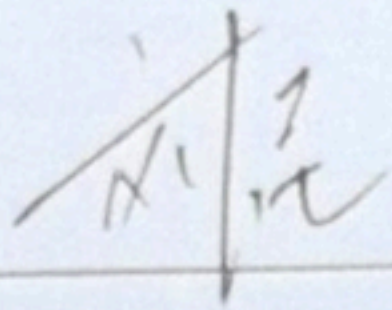
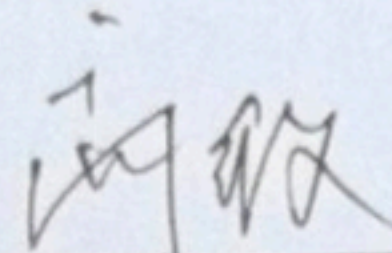
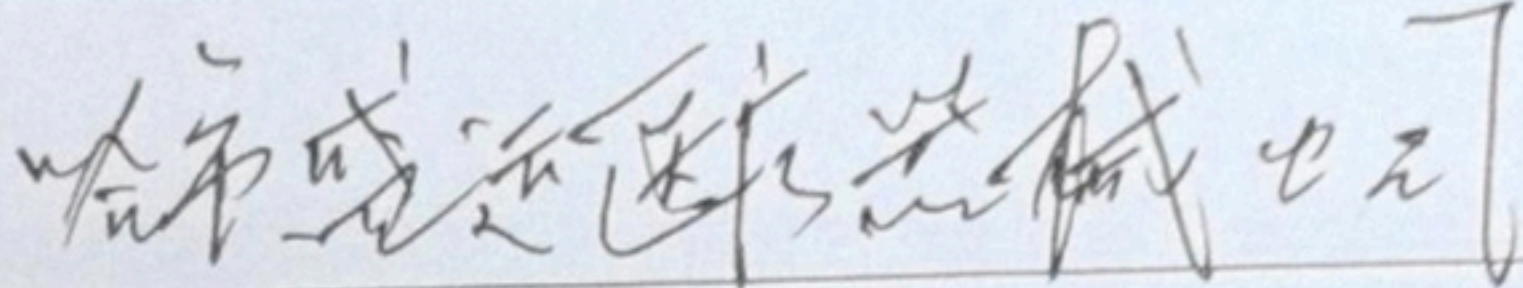
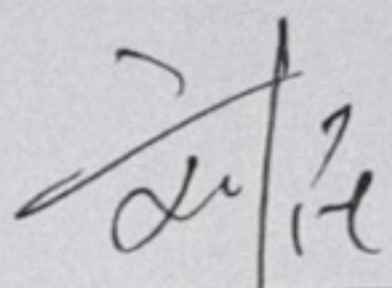
注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李博宇
	职称: 讲师
	工作单位: 黑龙江护理高等专科学校
项目信息	项目名称:
	供应商名称: 黑龙江巴迪泰供应链管理有限公司
专业人员论证意见	<p>经认真论证, 现有普门尿液蛋白分析仪(AUR-300)该设备配套试剂为走机专用产品, 其他暂无法替代, 符合政府采购法第三十七条规定, 建议以单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>李博宇</p>
	日期: 2024.2.19

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 
	工作单位: 
项目信息	项目名称:
	供应商名称: 黑龙江巴迪泰供应链管理有限公司
专业人员论证意见	<p> 经论证测试与分析结果, 性能和质量, 原 液量与析反ACR-300 只能采用该产品 两套使用试剂。黑龙江巴迪泰供应链 管理有限公司是深圳普门科技股份有限公司 在黑龙江区域的唯一供应商, 此情形 符合政府采购法中第三条只能从唯一供 应商采购的条件, 可以采用单一来源方 式采购。 </p>
专业人员签字	
	日期: 2024. 2. 19

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专业人员论证意见表

项目名称:

审核内容及意见	<p>论证意见：由于该院已购置西门康液蛋白分析仪(ACK-300)，且该设备配套试剂属于专机专用产品，第三方品牌无法替代。白蛋白源于提纯，因此，根据政府采购办法第三十一条规定，建议采用单一来源的方式从授权供应商处采购。</p>
全体评委签字	<p>李伟 刘昆 李博宇</p>

日期：2024年2月19日